

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



委托单位: 义煤综合应急救援大队直属四中队

样品名称:

低速风表

规格型号:

CFJ5

检验类别:

委托检验

检验日期:

2026年08月07日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 4721302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤综合应急救援大队直属四中队		
样品名称	煤矿用风速表		
规格型号	CFJ5		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
使用单位	义煤综合应急救援大队直属四中队		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室		
到样日期	2026 年 08 月 05 日		
生产厂家	鞍山市佳如矿光学仪器有限公司	出厂编号	70928
安标编号	MF A050008	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068
检验环境			
温度 (℃)	19.97	湿度 (%RH)	/
大气压 (Pa)	98365	其它	/

备注	
检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目符合标准要求。 

批准: 刘明军


审核: 梁卫花

主检: 梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固，分度线、标字清晰，指针平稳，开关灵活，回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.2m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.02m/s	合格
备 注				

风表曲线图

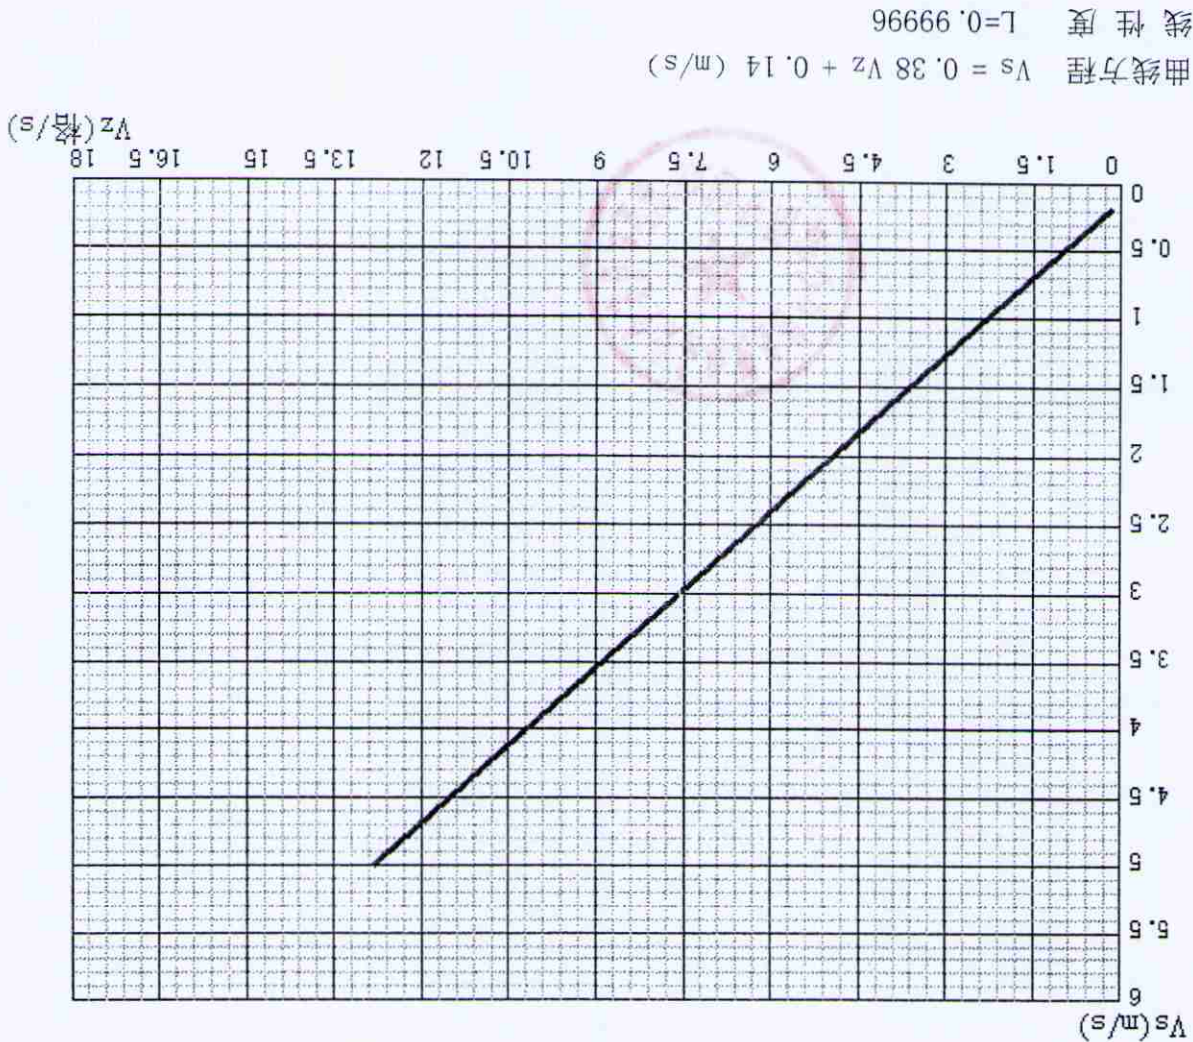

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



委托单位: 义煤综合应急救援大队直属四中队

样品名称:

低速风表

规格型号:

CFJ5

检验类别:

委托检验

检验日期:

2026年08月07日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)

注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	义煤综合应急救援大队直属四中队		
样品名称	煤矿用风速表		
规格型号	CFJ5		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	义煤综合应急救援大队直属四中队
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东测 51 号楼 3 楼 308 室		
到样日期	2026 年 08 月 05 日		
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	70922
安标编号	MTA050008	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA / T380-2007 《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表			
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068
检验环境			
温度（℃）	19.86	湿度（%RH）	/
大气压（Pa）	98370	其它	/

检验结论	依据 KA / T380-2007 《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求。		
备注			

批准: 刘永军

审核: 梁卫花


主检: 梁卫花



检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.18m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.01m/s	合格
备 注				

风表曲线图

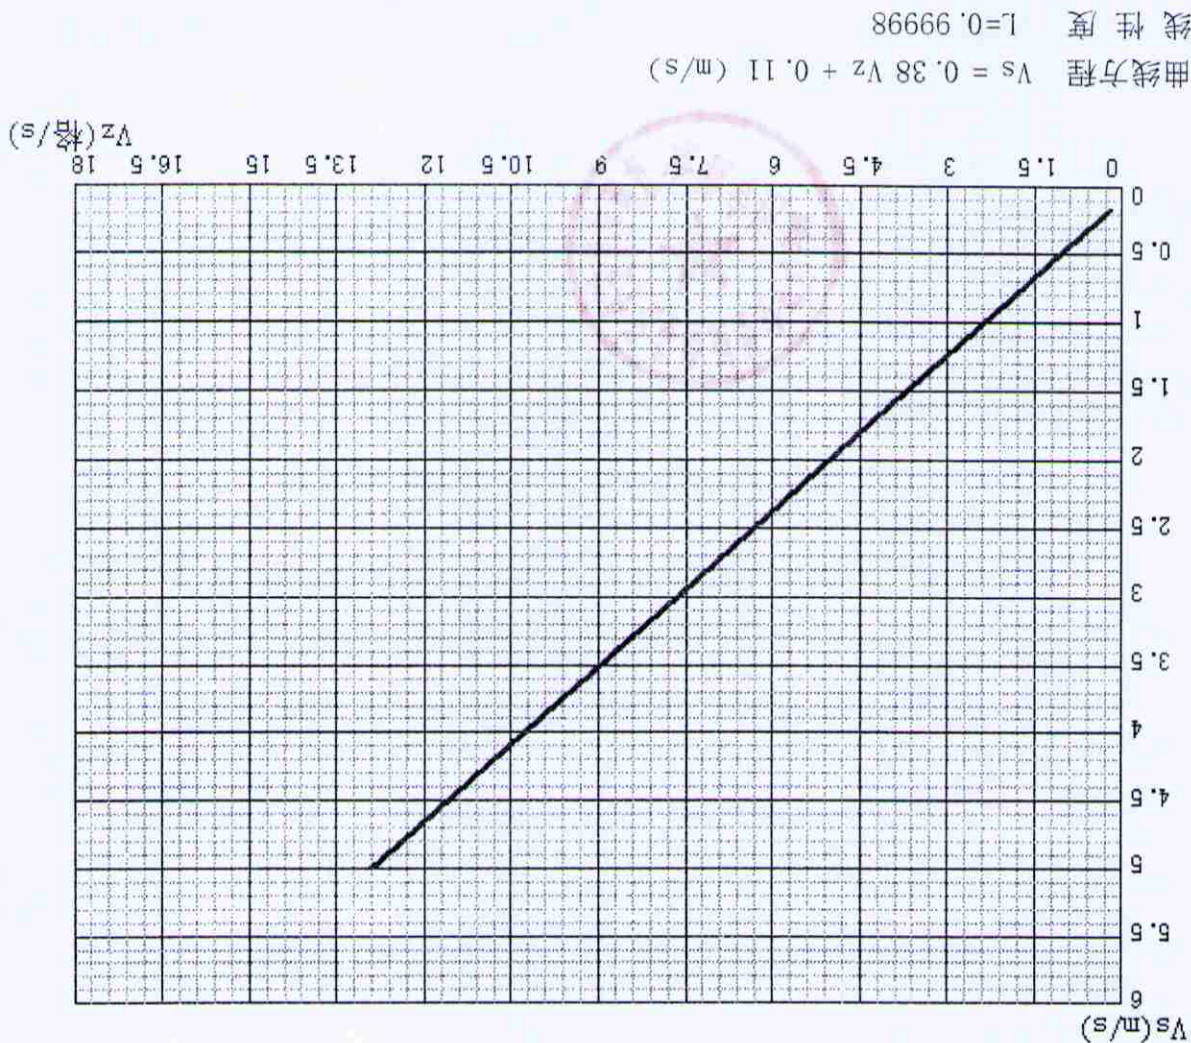

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



委托单位:	义煤综合应急救援大队直属四中队
样品名称:	低速风表
规格型号:	CFJ5
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月07日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	义煤综合应急救援大队直属四中队	地 址	宜阳县城关镇
------	-----------------	-----	--------

样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ5
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	义煤综合应急救援大队直属四中队

检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室	检验类别	委托检验
到样日期	2026年08月05日	检验日期	2026年08月07日
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	17156
安标编号	MFH040004	检验人员	梁卫花 禹磊

检验依据	KA / T380-2007《煤矿用风速表》		
------	------------------------	--	--

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
----	------	-------------------	--------

矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT110804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境			
------	--	--	--

温度(℃)	19.77	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98371	其它	/

检验结论	依据 KA / T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。		
备注	签发日期: 2026年08月07日		

批准: 刘淑华


审核: 梁卫花

主检: 梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.19m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.01m/s	合格
备 注				

风表曲线图

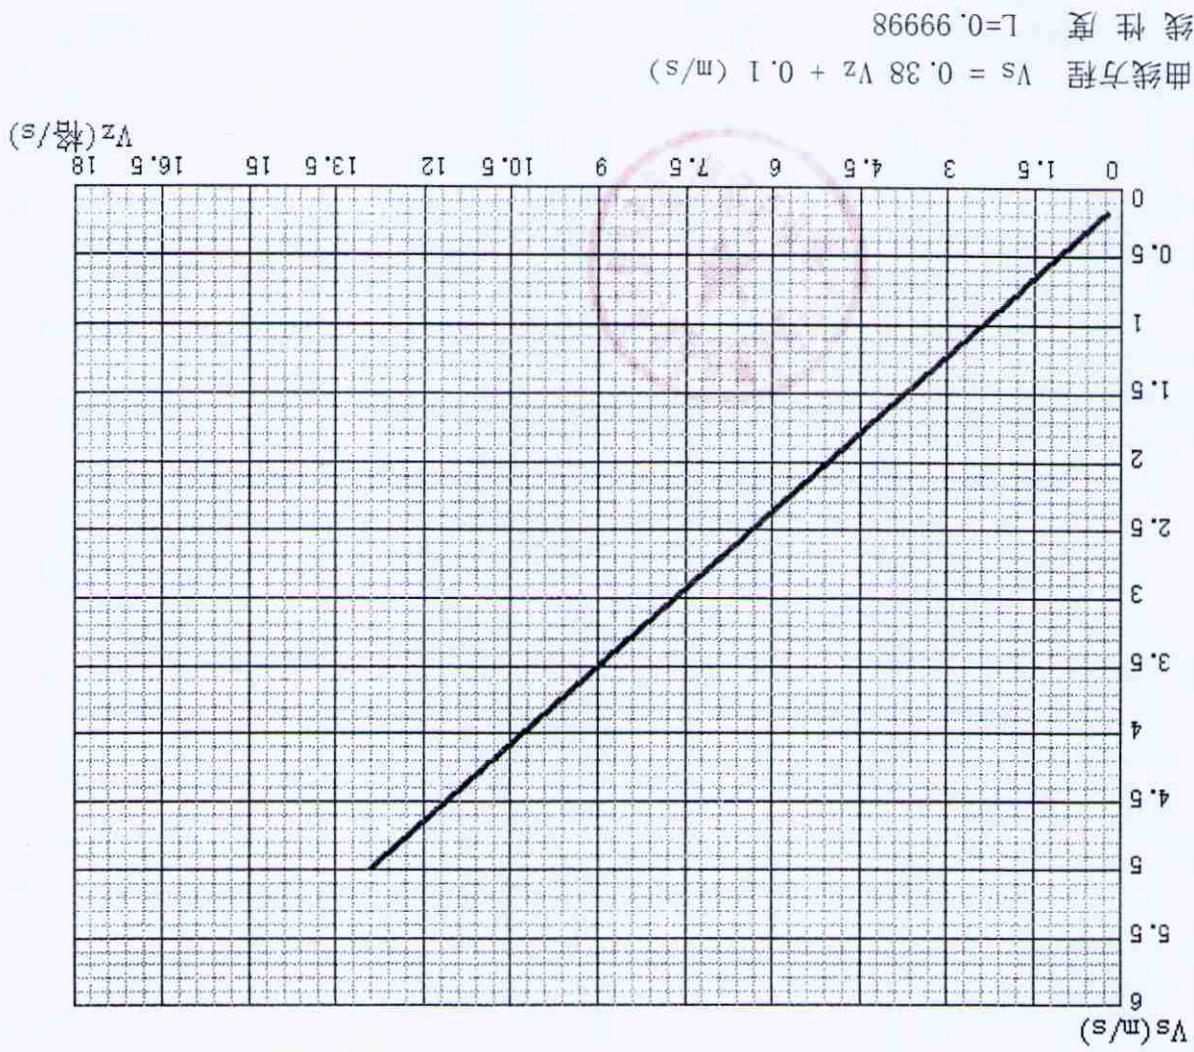

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	义煤综合应急救援大队直属四中队
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月07日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤综合应急救援大队直属四中队		
地址	宜阳县城关镇		
样品名称	煤矿用风速表		
规格型号	CFJ10		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
使用单位	义煤综合应急救援大队直属四中队		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月05日		
检验日期	2026年08月07日		
生产厂家	鞍山市佳如矿光学仪器有限公司	出厂编号	70466
安标编号	MFA050009	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT110804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	19.75	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98370	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求。		
备注			




批准: 2026年8月5日 审核: 梁卫花 主检: 禹磊

签发日期: 2026年08月07日

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.27m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.06m/s	合格
备 注				

风表曲线图

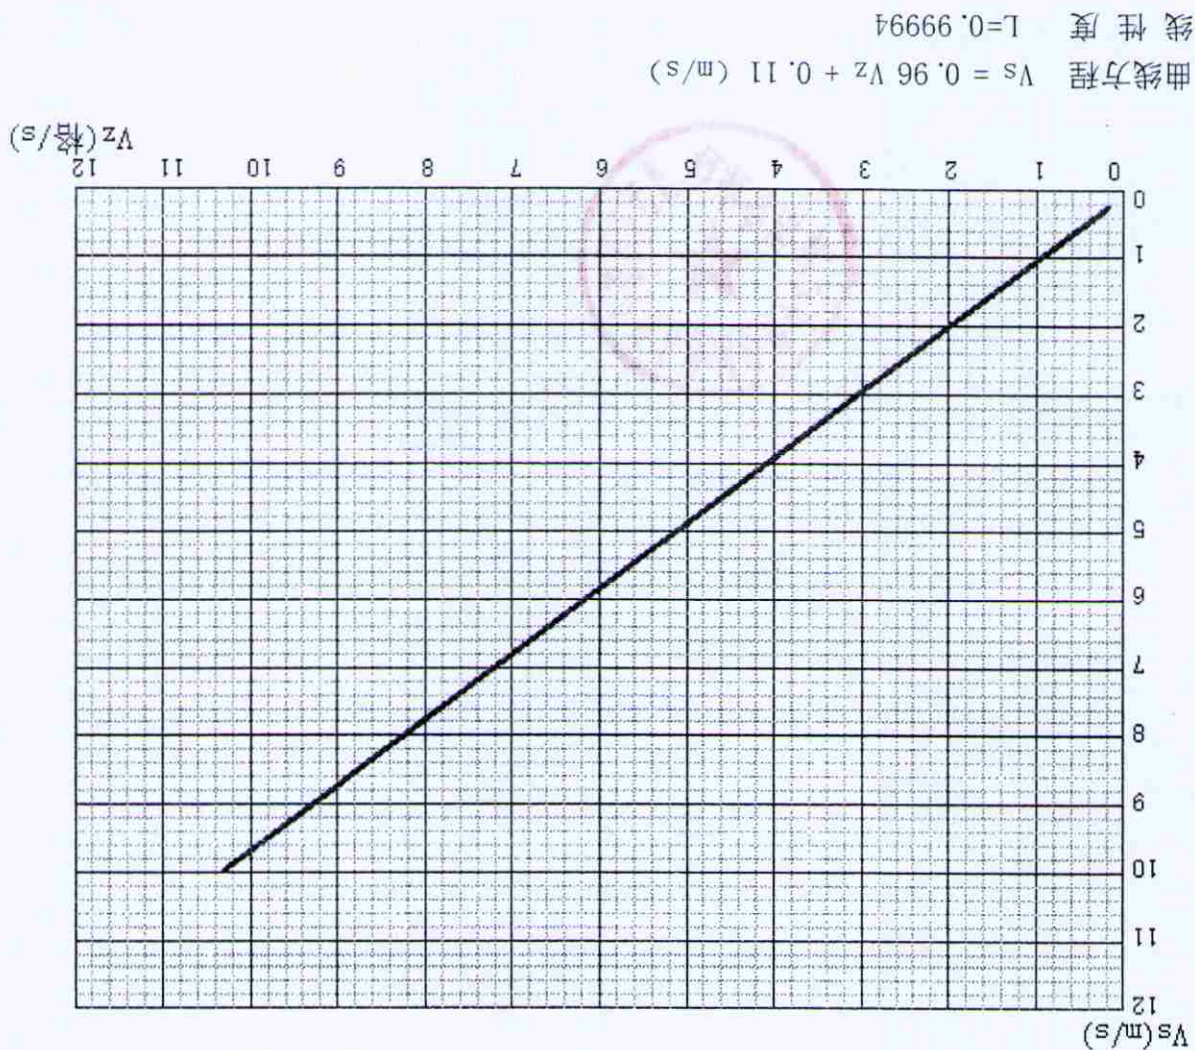

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	义煤综合应急救援大队直属四中队
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026 年 08 月 07 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤综合应急救援大队直属四中队	地 址	宜阳县城关镇
------	-----------------	-----	--------

样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ10
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	义煤综合应急救援大队直属四中队

检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
到样日期	2026 年 08 月 05 日	检验日期	2026 年 08 月 07 日
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	70328
安标编号	MEA050009	检验人员	梁卫花 禹磊

检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》
------	----------------------

检验设备 (标准物质) 一览表			
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068

检验环境			
温度 (℃)	19.86	湿度 (%RH)	/
大气压 (Pa)	98372	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验, 判定所检项目 符合标准要求。
备注	

批准: 刘淑琴

审核: 梁卫花


主检: 梁卫花



检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.34m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.06m/s	合格
备 注				

风表曲线图

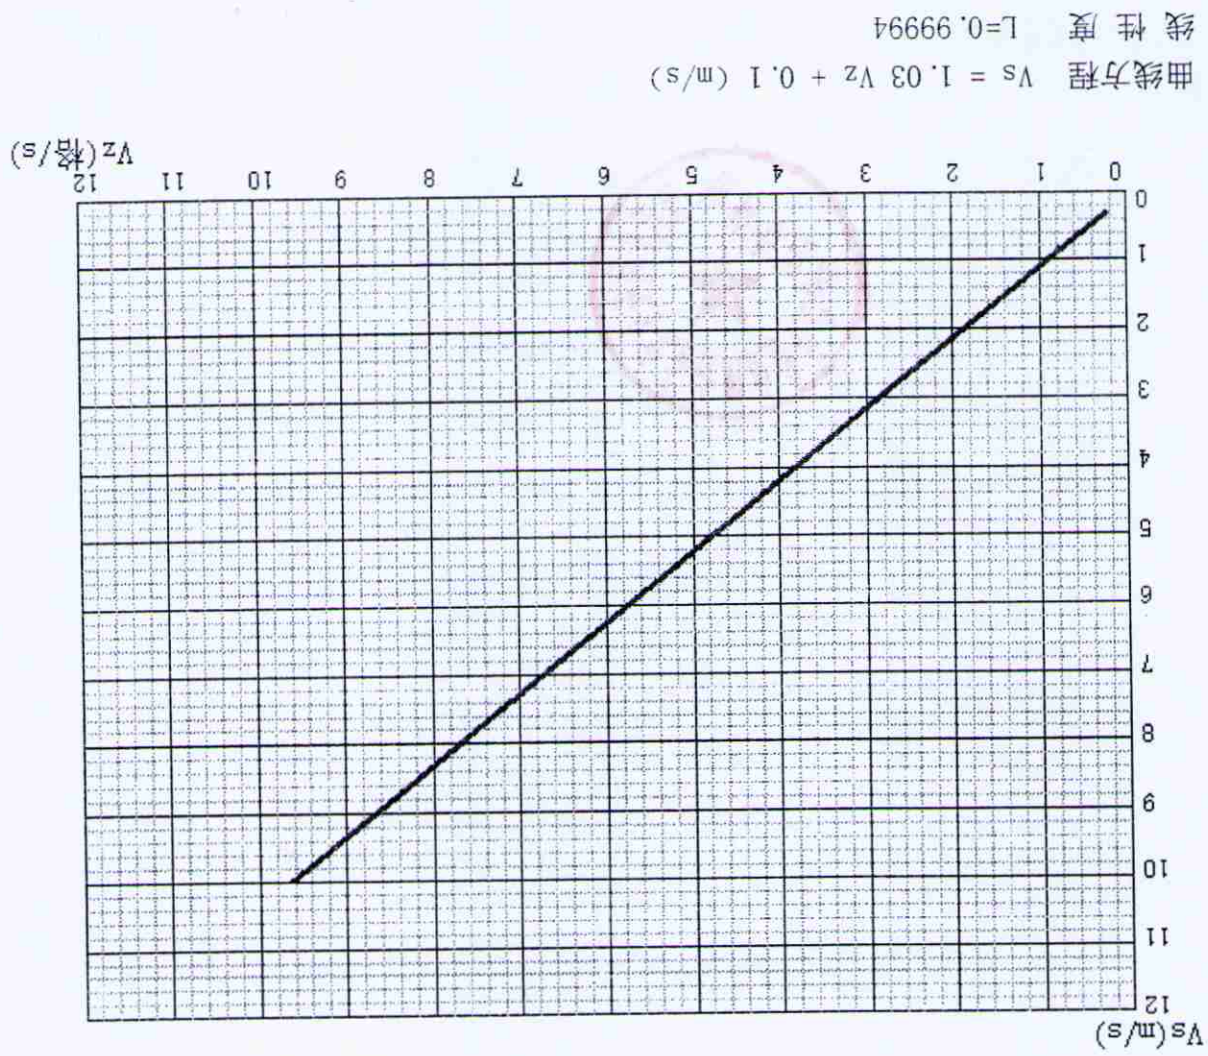

以下无内容