



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位：	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称：	中速风表
规格型号：	CFJ10
检验类别：	委托检验
检验日期：	2026年08月17日

检验单位： 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司	地 址	陕州区观音堂镇
------	--------------	-----	---------

样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ10
------	--------	------	-------

样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	三门峡观音堂煤业有限公司
------	-------------------------	------	--------------

检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
------	-------------------------------	------	------

到样日期	2026 年 08 月 11 日	检验日期	2026 年 08 月 17 日
------	------------------	------	------------------

生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	82391
------	-----------------	------	-------

安标编号	MFA050009	检验人员	梁卫花 禹磊
------	-----------	------	--------

检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		
------	----------------------	--	--

检验设备 (标准物质) 一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
----	------	-------------------	--------

矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
--------------	-----------------------	----	----------------

压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
-------	------------------------	-------	----------------

皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
-----	--------	----	----------------

温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
-----	-----	---------	---------------

温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068
--------	-----------------	-------	---------------

检验环境

温度 (℃)	19.97	湿度 (%RH)	/
--------	-------	----------	---

大气压 (Pa)	98379	其它	/
----------	-------	----	---

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。		
备注			

批准: 刘淑华

审核: 梁卫花


主检: 禹磊



检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.31m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.05m/s	合格
备 注				

风表曲线图

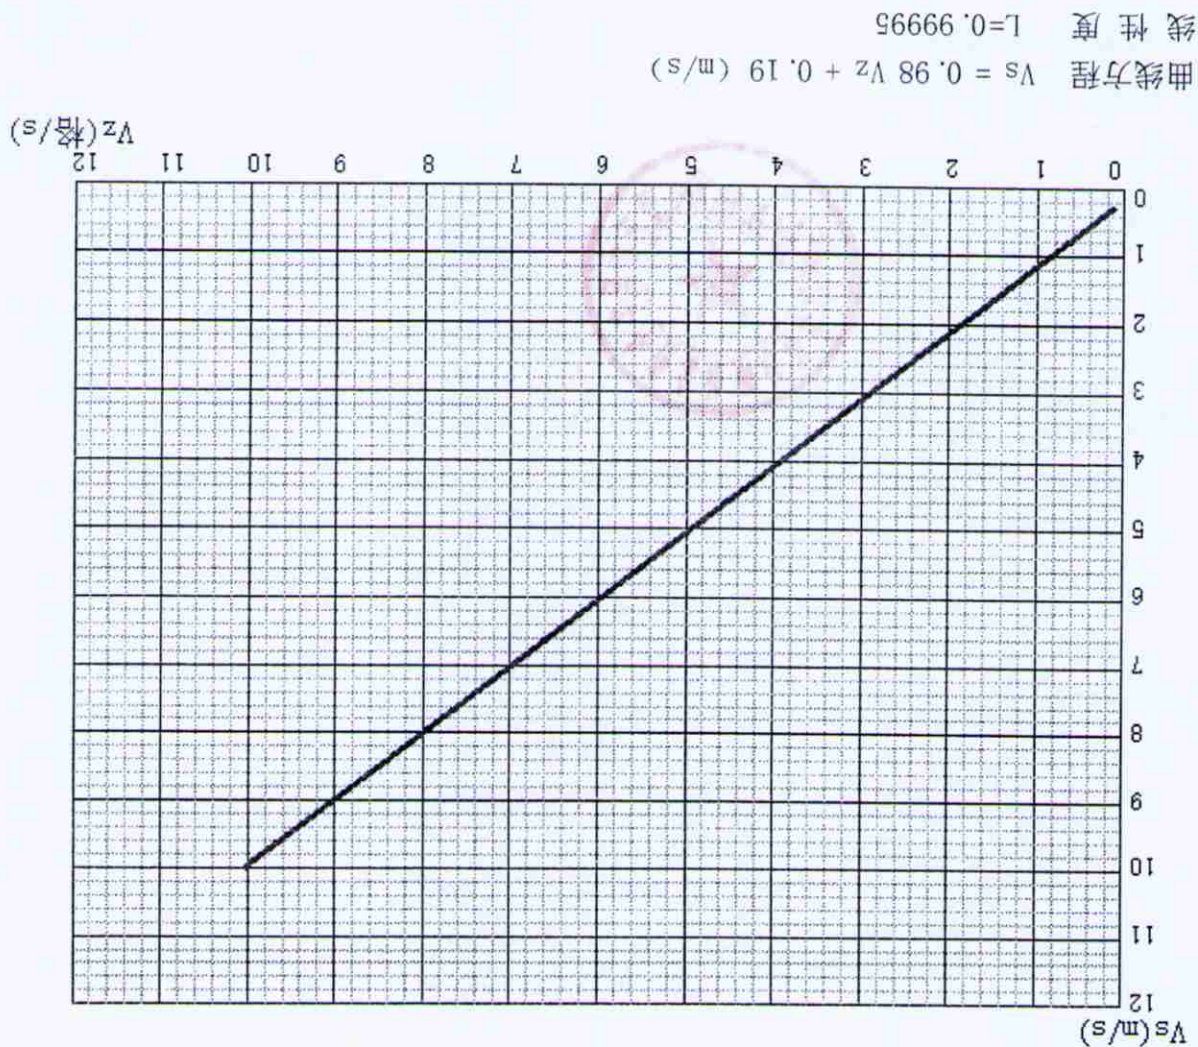

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



委托单位:

三门峡观音堂煤业有限公司

样品名称:

中速风表

规格型号:

CFJ10

检验类别:

委托检验

检验日期:

2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月11日		
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	82221
安标编号	MEA050009	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表

名称	规格型号	不确定度、准确等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	20.05	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98381	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求		
备注			

批准: 刘海洋

审核: 梁卫花

主检: 禹磊




签发日期: 2026年08月17日



检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平 稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.35m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.05m/s	合格
备 注				

风表曲线图

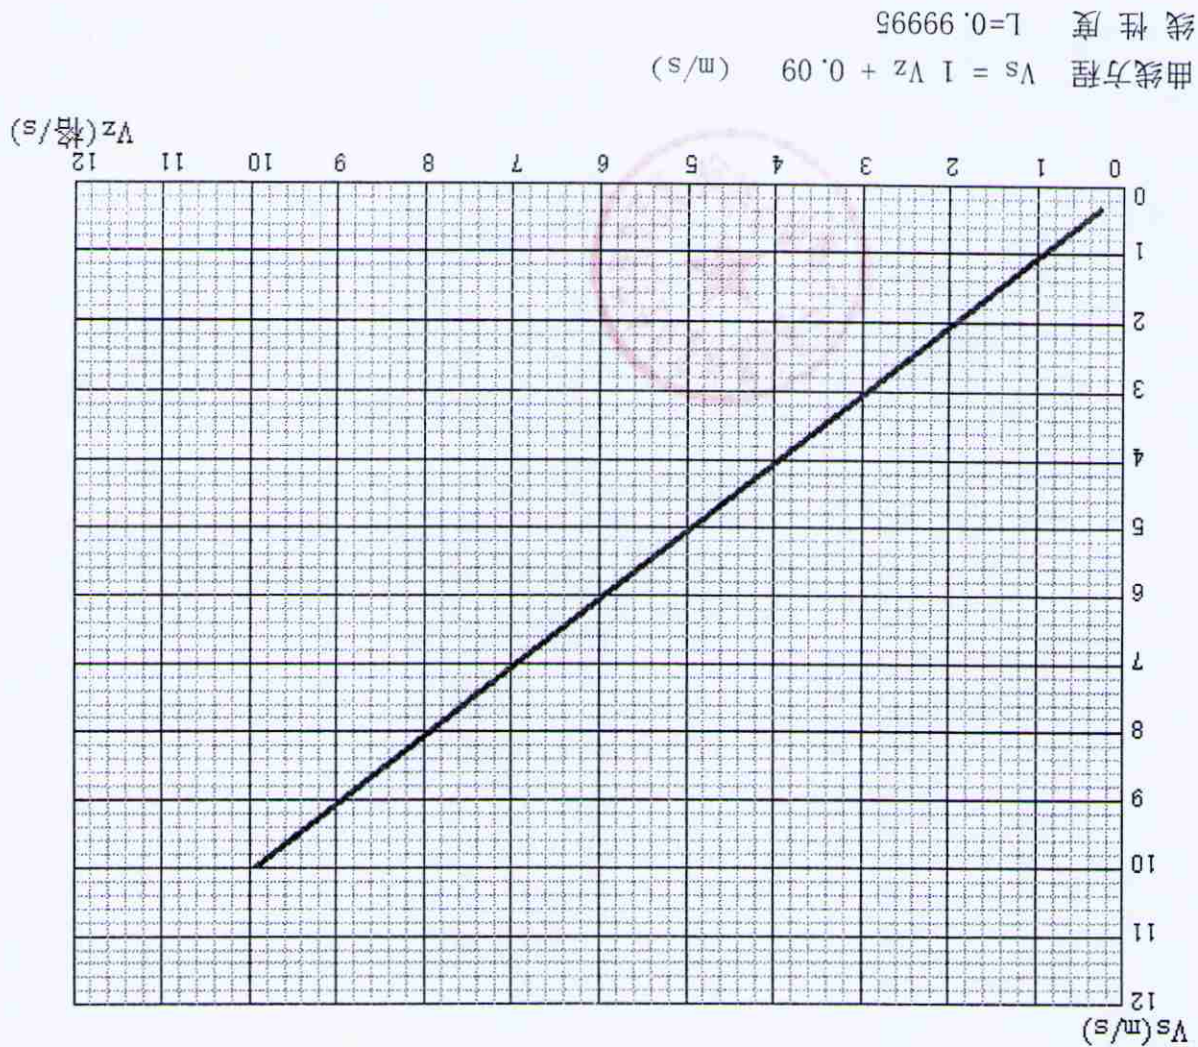

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司	地 址	陕州区观音堂镇
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ10
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	三门峡观音堂煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室	检验类别	委托检验
到样日期	2026年08月11日	检验日期	2026年08月17日
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	42026
安标编号	MTA050009	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	20.13	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98389	其它	/
检 验 结 论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目符合标准要求。		
备注			

批准: 刘卫华

审核: 梁卫花

主检: 禹磊




签发日期: 2026年08月17日



检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固，分度线、标字清晰，指针平稳，开关灵活，回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.3m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.05m/s	合格
备 注				

风表曲线图

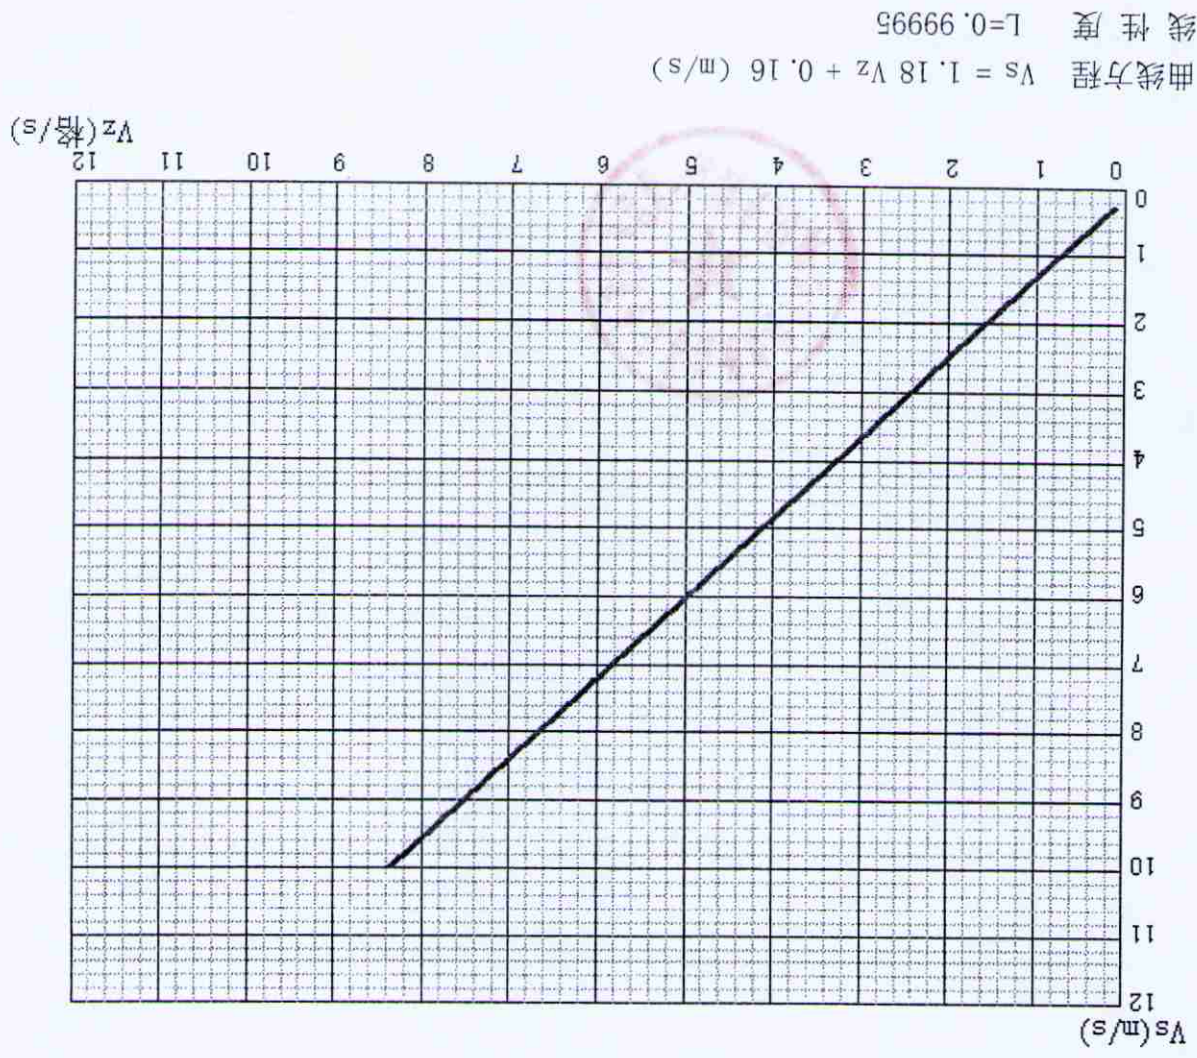

以下无内容

煤矿用风速表
检 验 报 告



豫煤监2503

委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称:	高速风表
规格型号:	CFJ25
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司	地 址	陕州区观音堂镇
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ25
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	三门峡观音堂煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室	检验类别	委托检验
到样日期	2026年08月11日	检验日期	2026年08月17日
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	260557
安标编号	MTA130069	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度（℃）	20.28	湿度（%RH）	/
大气压（Pa）	98385	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求。		
备注			



批准: 梁卫花


审核: 梁卫花

主检: 禹磊

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固，分度线、标字清晰，指针平稳，开关灵活，回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.34m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.8~25 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.07m/s	合格
备 注				

风表曲线图

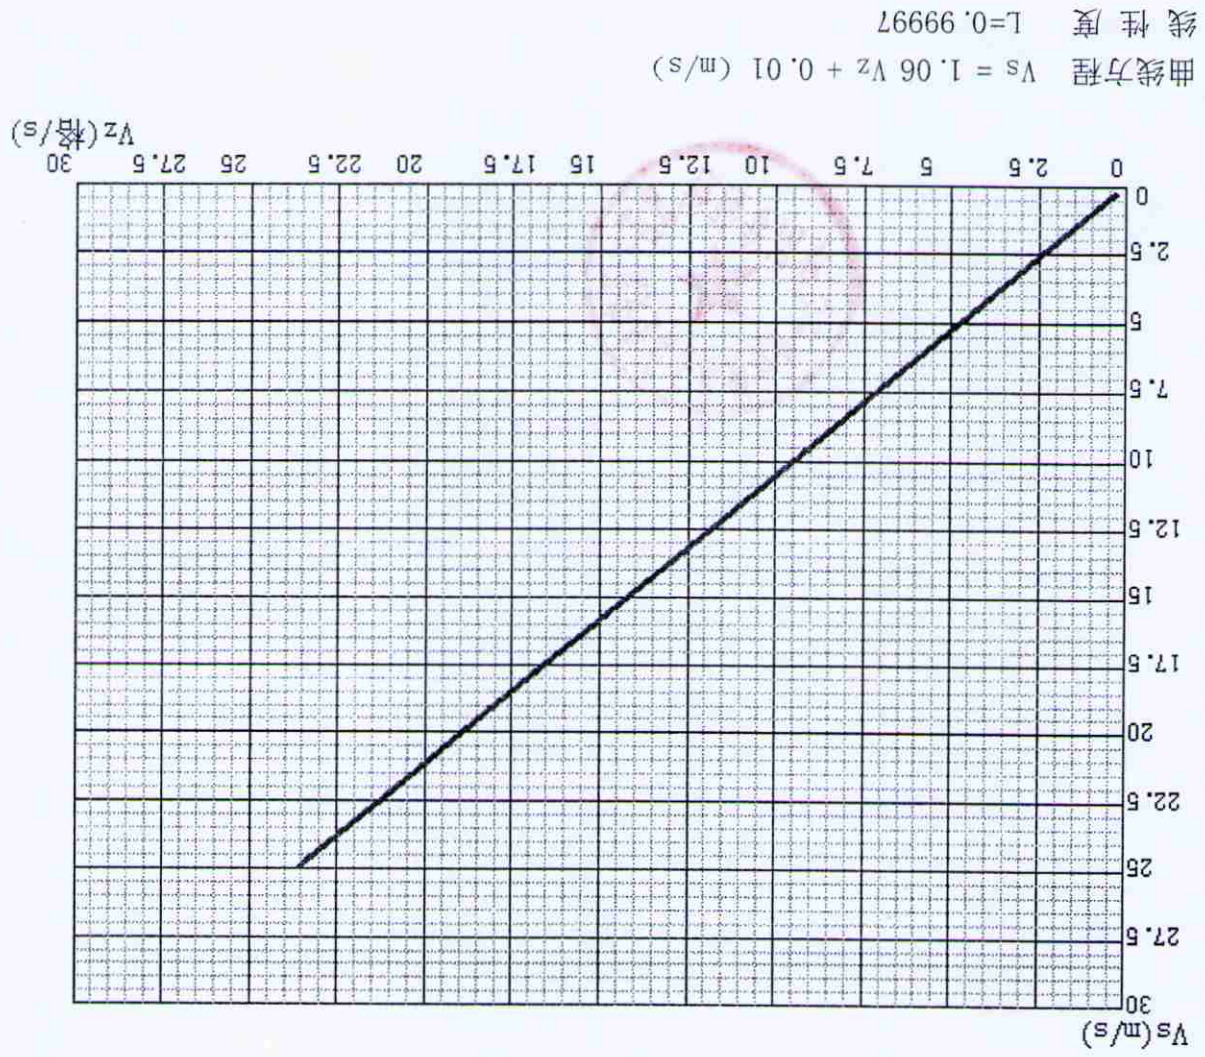

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



三门峡观音堂煤业有限公司

委托单位:

高速风表

样品名称:

CFJ25

规格型号:

委托检验

检验类别:

2026年08月17日

检验日期:

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)

注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司	地 址	陕州区观音堂镇
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ25
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	三门峡观音堂煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
到样日期	2026 年 08 月 11 日	检验日期	2026 年 08 月 17 日
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	80885
安标编号	MEA130069	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068

检验环境

温度 (℃)	20.56	湿度 (%RH)	/
大气压 (Pa)	98383	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求。		
备注	签发日期: 2026 年 08 月 17 日		

批准: 刘沙平


审核: 梁卫花

主检: 禹磊

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件 稳, 开关灵活, 回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格	
2	起动风速 低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.4m/s	合格	
3	风速测量 范围 低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.8~25 m/s	合格	
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.06m/s	合格
备 注				

风表曲线图

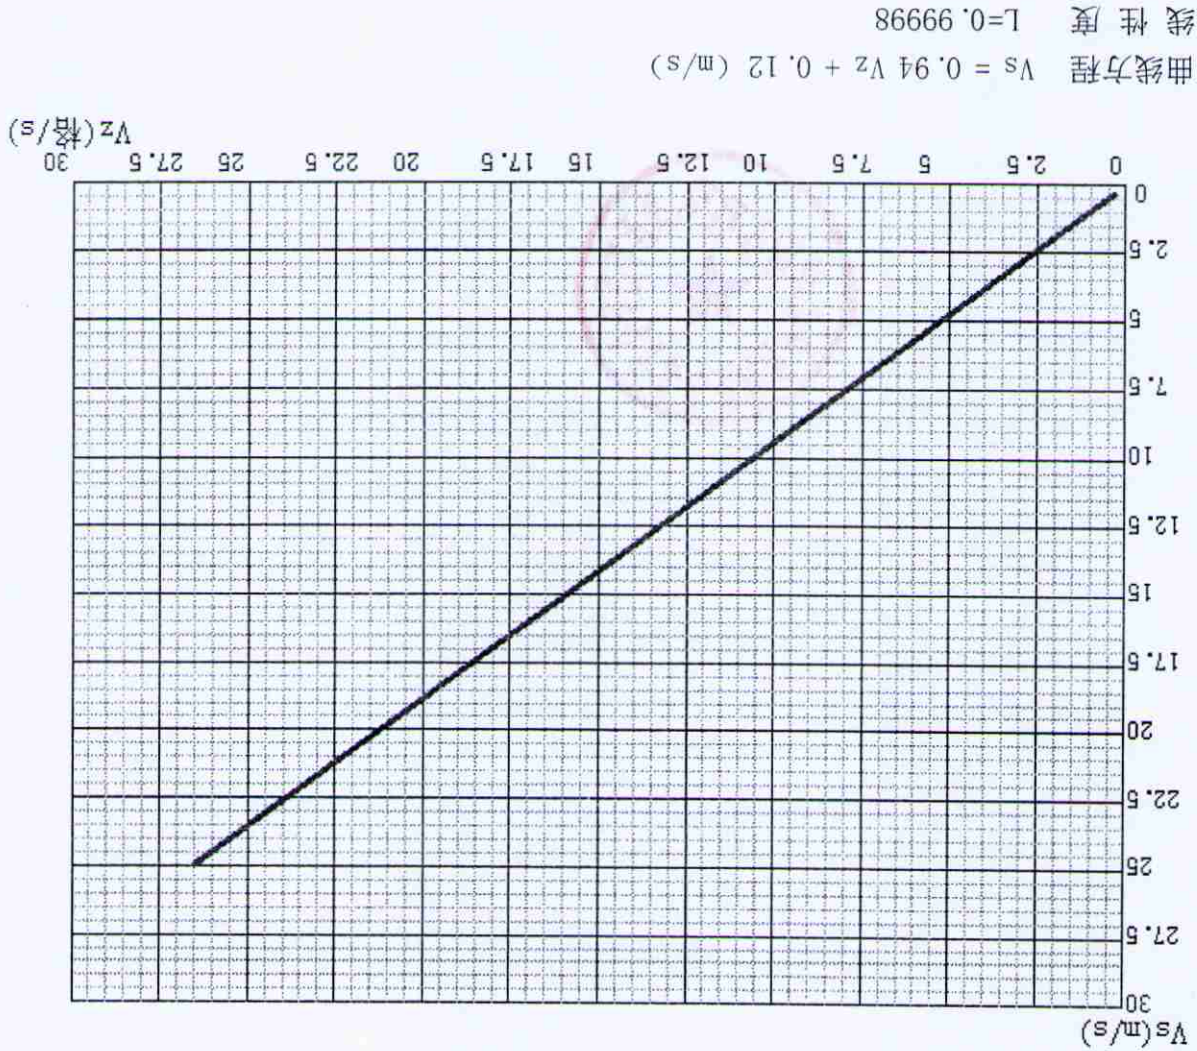

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称:	高速风表
规格型号:	CFJ25
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司	地 址	陕州区观音堂镇
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ25
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	三门峡观音堂煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室	检验类别	委托检验
到样日期	2026年08月11日	检验日期	2026年08月17日
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	26872
安标编号	MFH040002	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表			
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CDIA22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068
检验环境			
温度(℃)	20.91	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98395	其它	/

备注			
检 验 结 论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。		
签发日期	2026年08月17日		

批准: 刘卫华


审核: 梁卫花

主检: 禹磊

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.43m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.8~25 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.08m/s	合格
备 注				

风表曲线图

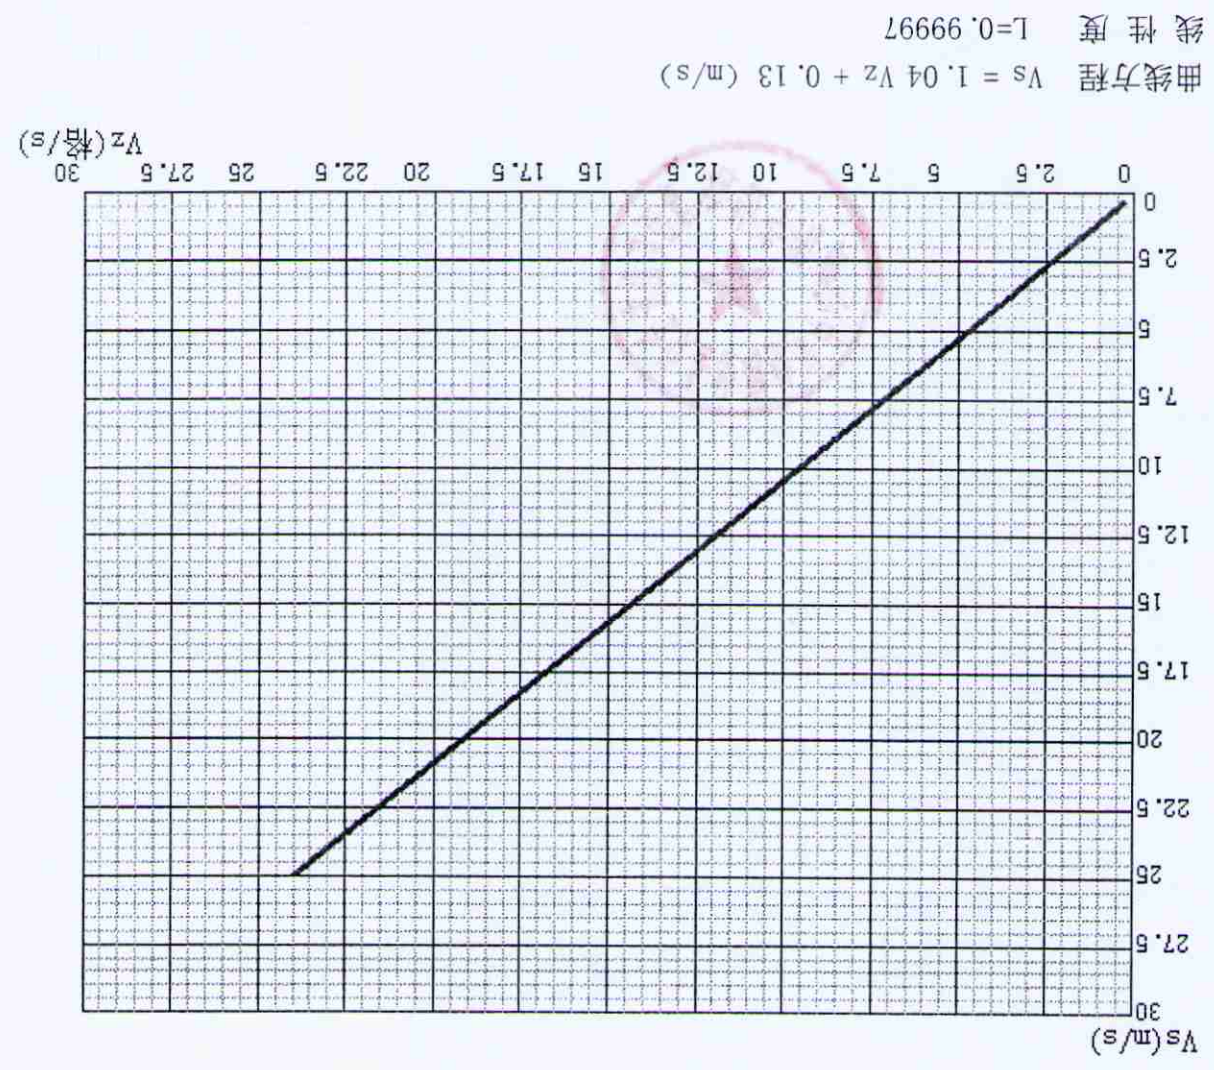

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称:	高速风表
规格型号:	CFJ25
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司		
地址	陕州区观音堂镇		
样品名称	煤矿用风速表		
规格型号	CFJ25		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室		
到样日期	2026 年 08 月 11 日		
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	27016
安标编号	MFH040002	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068

检验环境

温度 (℃)	21.05	湿度 (%RH)	/
大气压 (Pa)	98394	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目符合标准要求。		
备注	（检验专用章） 签发日期：2026 年 08 月 17 日		

批准: 刘海洋


审核: 梁卫花

主检: 禹磊

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.36m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.8~25 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.05m/s	合格
备 注				

风表曲线图

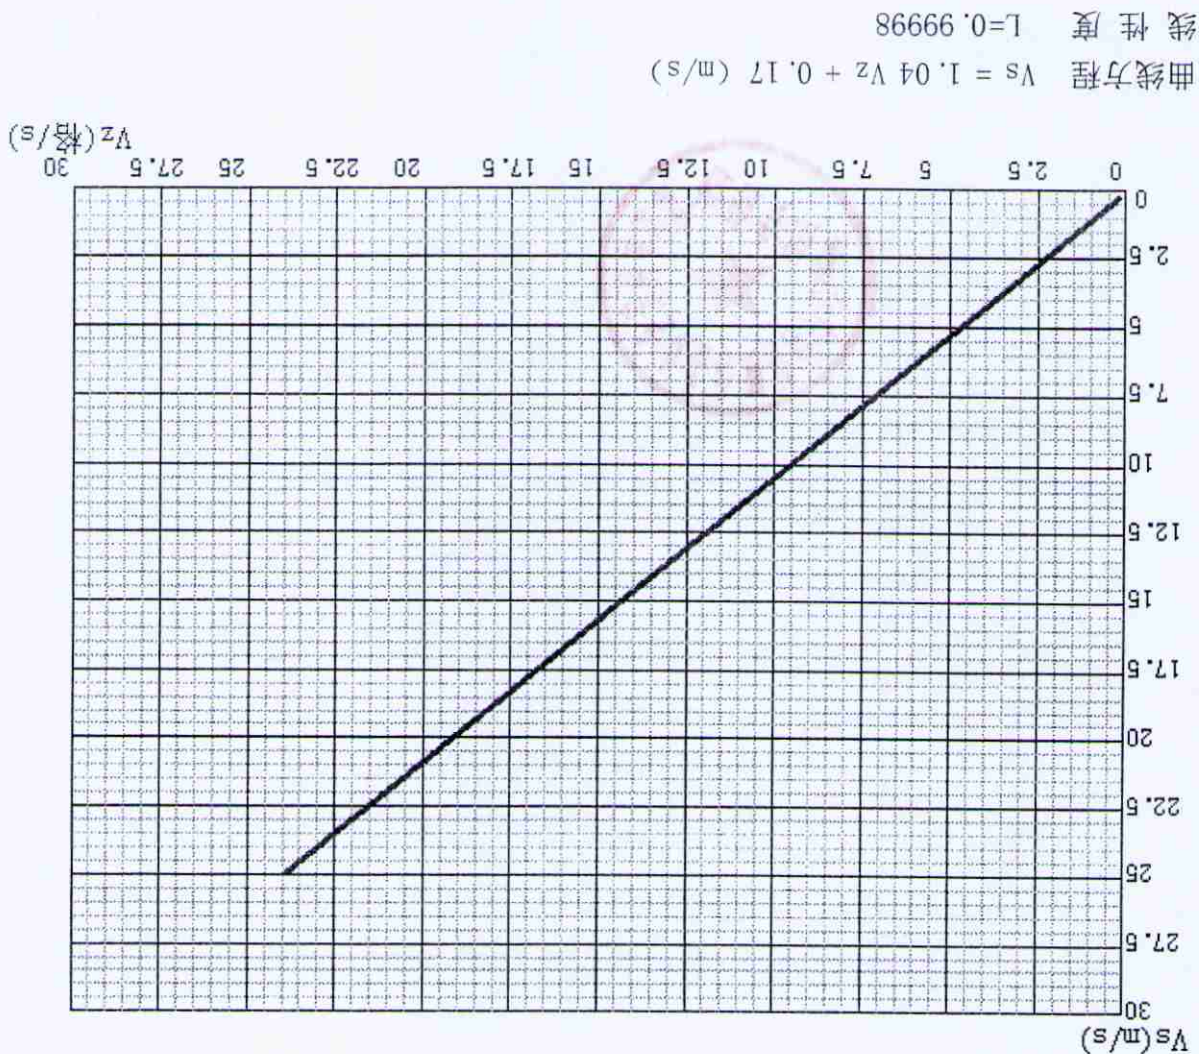

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月11日		
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	42173
安标编号	MFH040003	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1B4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	21.12	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98396	其它	/

备注			
检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。 求。 (检验专用章) 2026年08月17日		

批准: 刘少平


审核: 梁卫花

主检: 禹磊

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固，分度线、标字清晰，指针平稳，开关灵活，回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.32m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.05m/s	合格
备 注				

风表曲线图

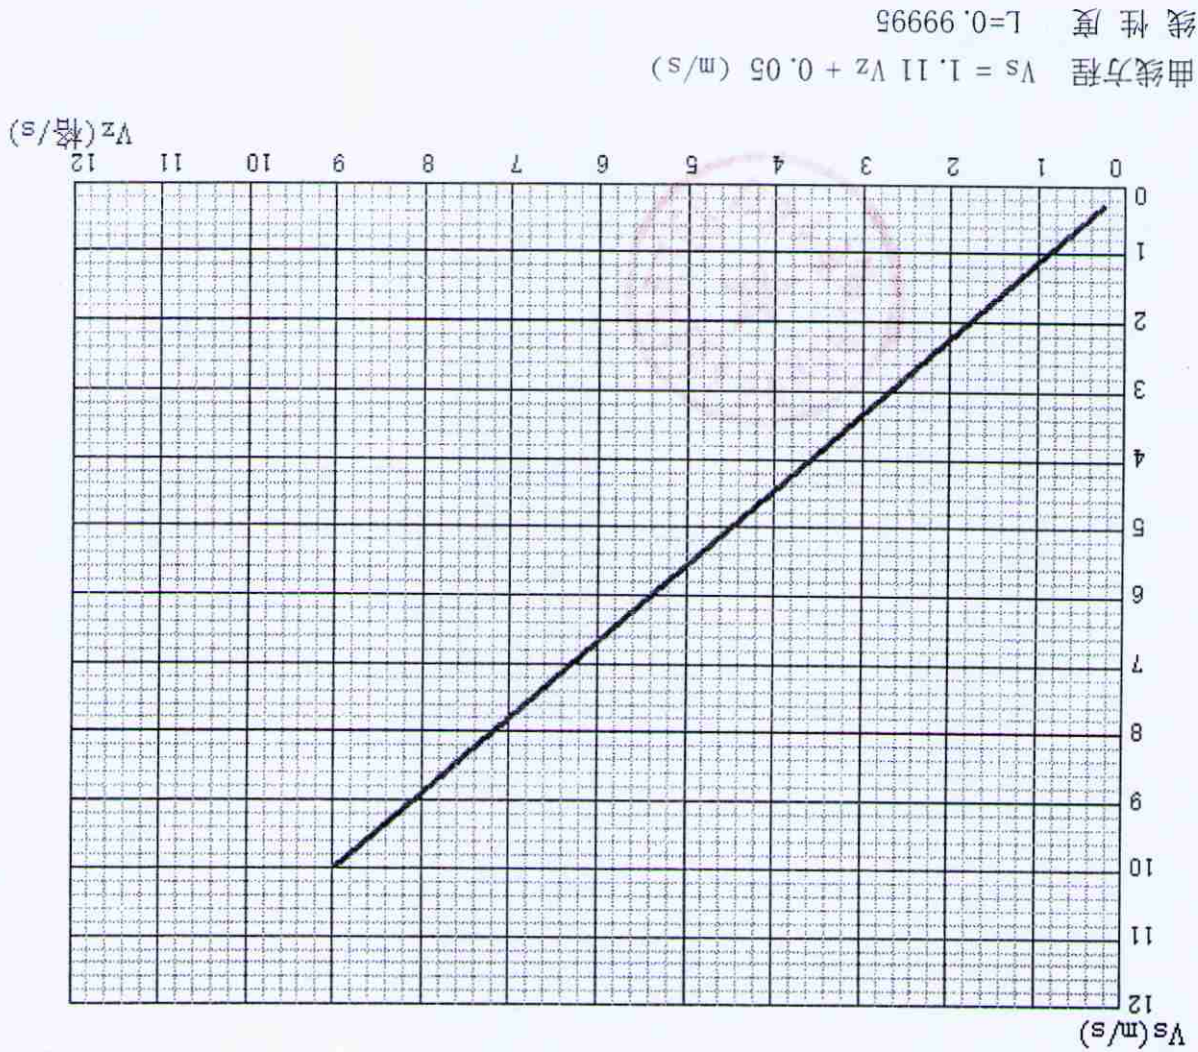

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月11日		
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	42052
安标编号	MFH040003	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1B4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	20.99	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98400	其它	/

备注			
检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。 (检验专用章) 签发日期: 2026年08月17日		

批准: 刘明华


审核: 梁卫花

主检: 禹磊

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.33m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.06m/s	合格
备 注				

风表曲线图

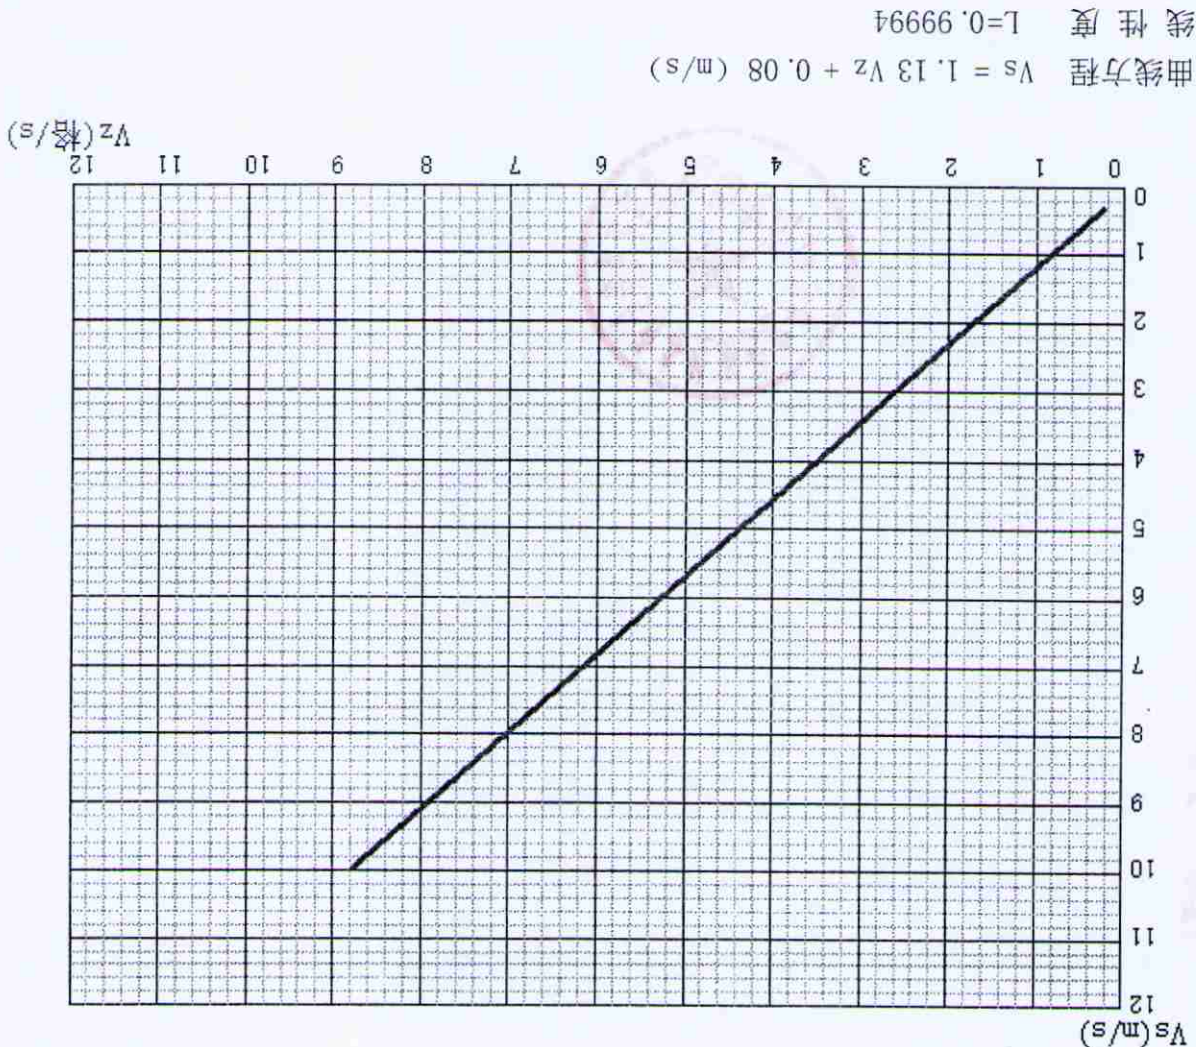

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位：	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称：	低速风表
规格型号：	CFJ5
检验类别：	委托检验
检验日期：	2026年08月17日

检验单位： 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司	地 址	陕州区观音堂镇
------	--------------	-----	---------

样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ5
------	--------	------	------

样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	三门峡观音堂煤业有限公司
------	-------------------------	------	--------------

检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
------	-------------------------------	------	------

到样日期	2026 年 08 月 11 日	检验日期	2026 年 08 月 17 日
------	------------------	------	------------------

生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	0507245
------	------------	------	---------

安标编号	MFH040004	检验人员	梁卫花 禹磊
------	-----------	------	--------

检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		
------	----------------------	--	--

检验设备（标准物质）一览表			
---------------	--	--	--

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
----	------	-------------------	--------

矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
--------------	-----------------------	----	----------------

压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
-------	------------------------	-------	----------------

皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
-----	--------	----	----------------

温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
-----	-----	---------	---------------

温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068
--------	-----------------	-------	---------------

检验环境			
------	--	--	--

温度 (℃)	21.04	湿度 (%RH)	/
--------	-------	----------	---

大气压 (Pa)	98383	其它	/
----------	-------	----	---

检 验 结 论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求		
	求_____。		

备注	签发日期: 2026 年 08 月 17 日		
----	------------------------	--	--

批准: 刘少华

审核: 梁卫花


主检: 禹磊



检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.17m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.02m/s	合格
备 注				

风表曲线图

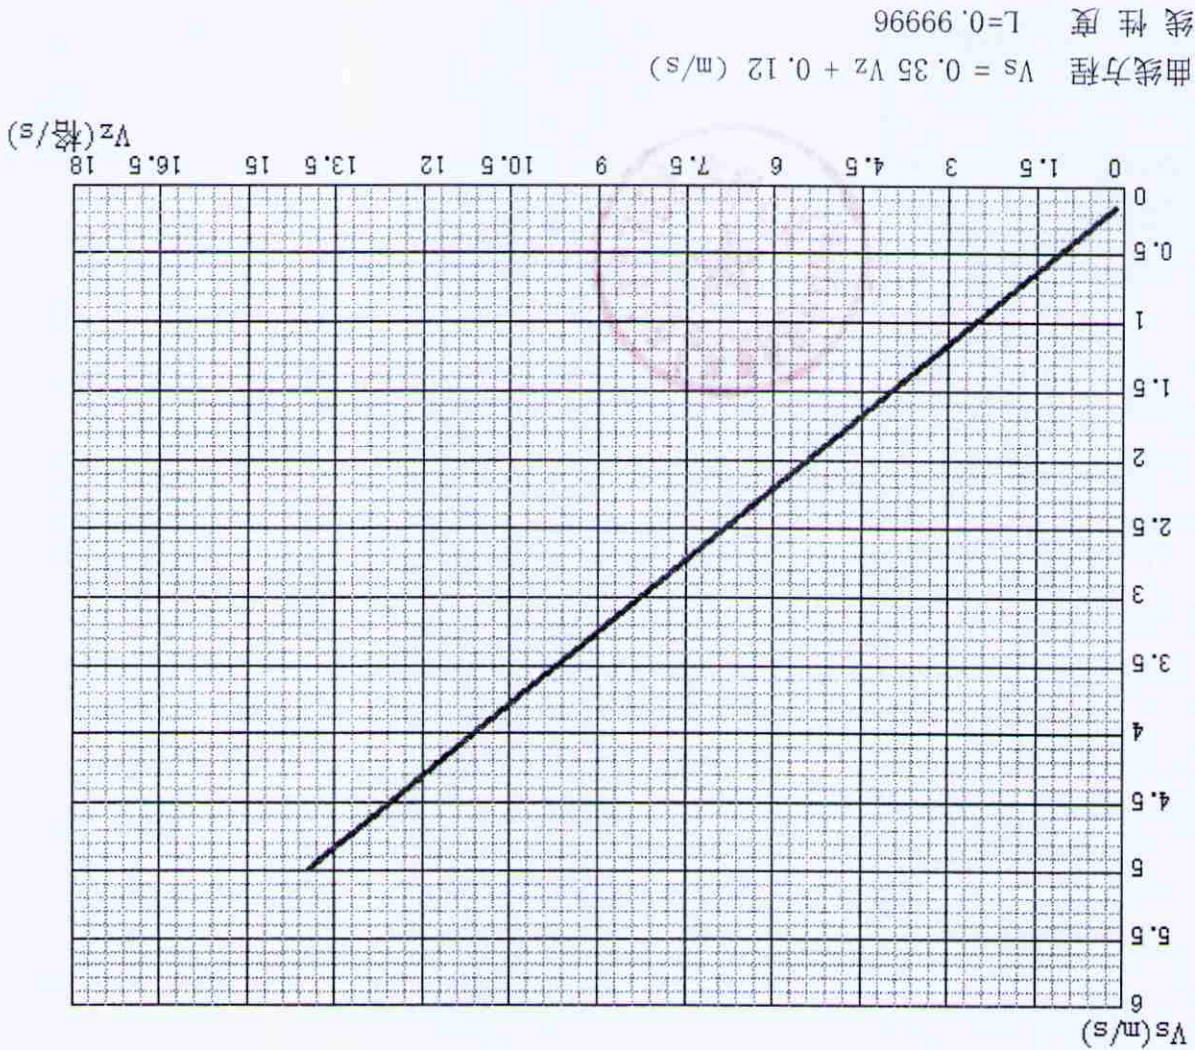

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
样品名称:	低速风表
规格型号:	CFJ-5
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月17日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	三门峡观音堂煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室		
到样日期	2026 年 08 月 11 日		
生产厂家	陕西信达煤矿安全装备有限公司	出厂编号	0512306
安标编号	MFA060011	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1B4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1 级	1026CT0302068

检验环境

温度 (℃)	20.91	湿度 (%RH)	/
大气压 (Pa)	98373	其它	/

备注			
检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求。		



签发日期: 2026 年 08 月 17 日

批准: 刘少华


审核: 梁卫花

主检: 禹磊

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.19m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.02m/s	合格
备 注				

风表曲线图

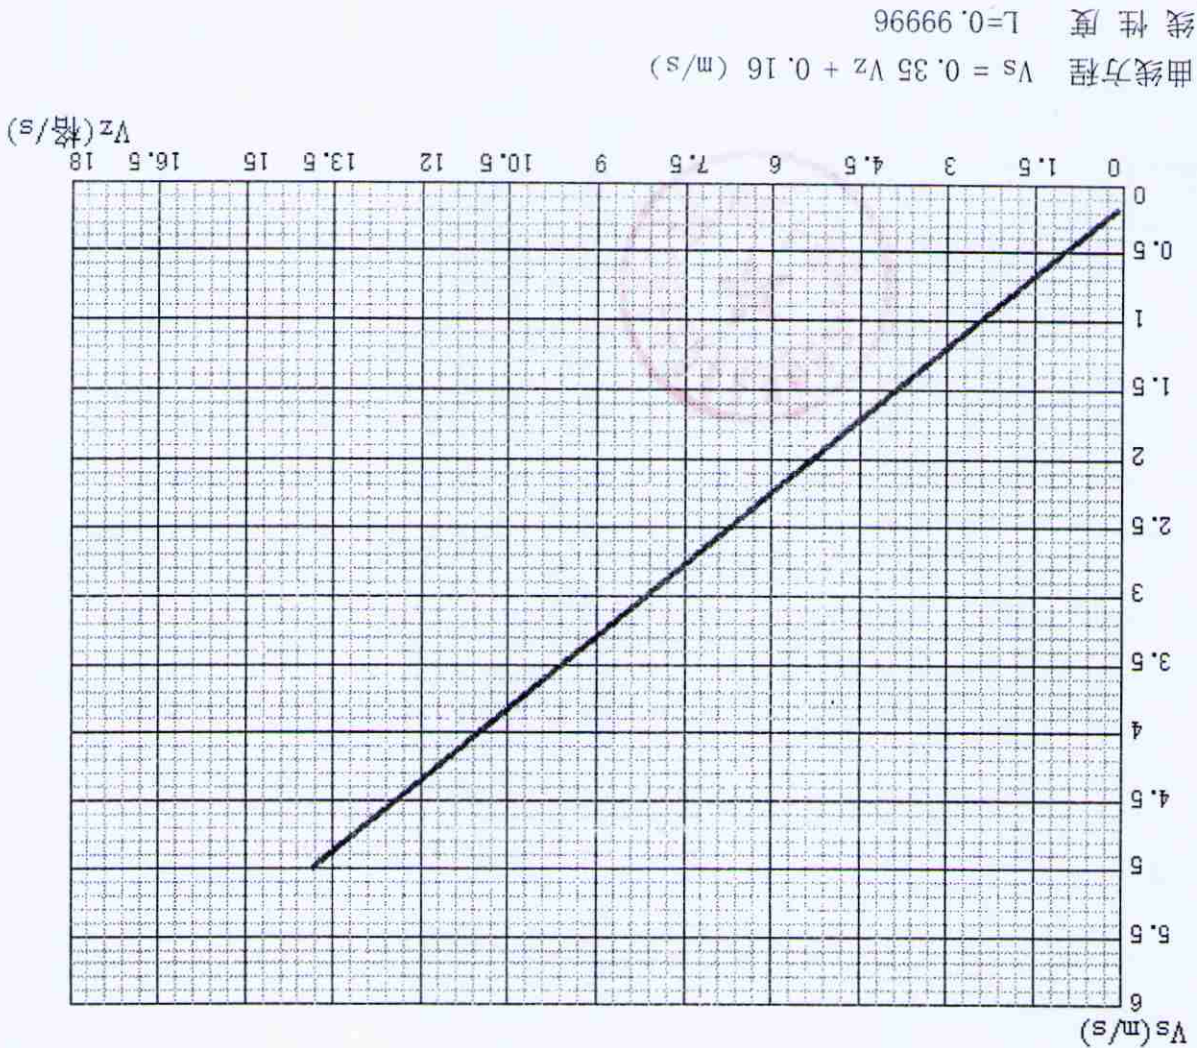

以下无内容