



豫煤监2503

煤矿用风速表 检 验 报 告

委托单位: 汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿

样品名称: 高速风表

规格型号: CFJ25

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 09 月 04 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心

(公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码: 472302

联 系 电 话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿	地 址	汝州市蟒川镇黑龙庙村
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ25
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
到样日期	2026 年 09 月 02 日	检验日期	2026 年 09 月 04 日
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	1064
安标编号	MFH040002	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXX	0.1 级	1026CT0302068

检验环境

温 度 (℃)	17.92	湿度 (%RH)	/
大气压 (Pa)	98991	其 它	/

检
验
结
论依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要
求。

(检验专用章)

签发日期：2026 年 09 月 04 日

备注

批准：刘少军

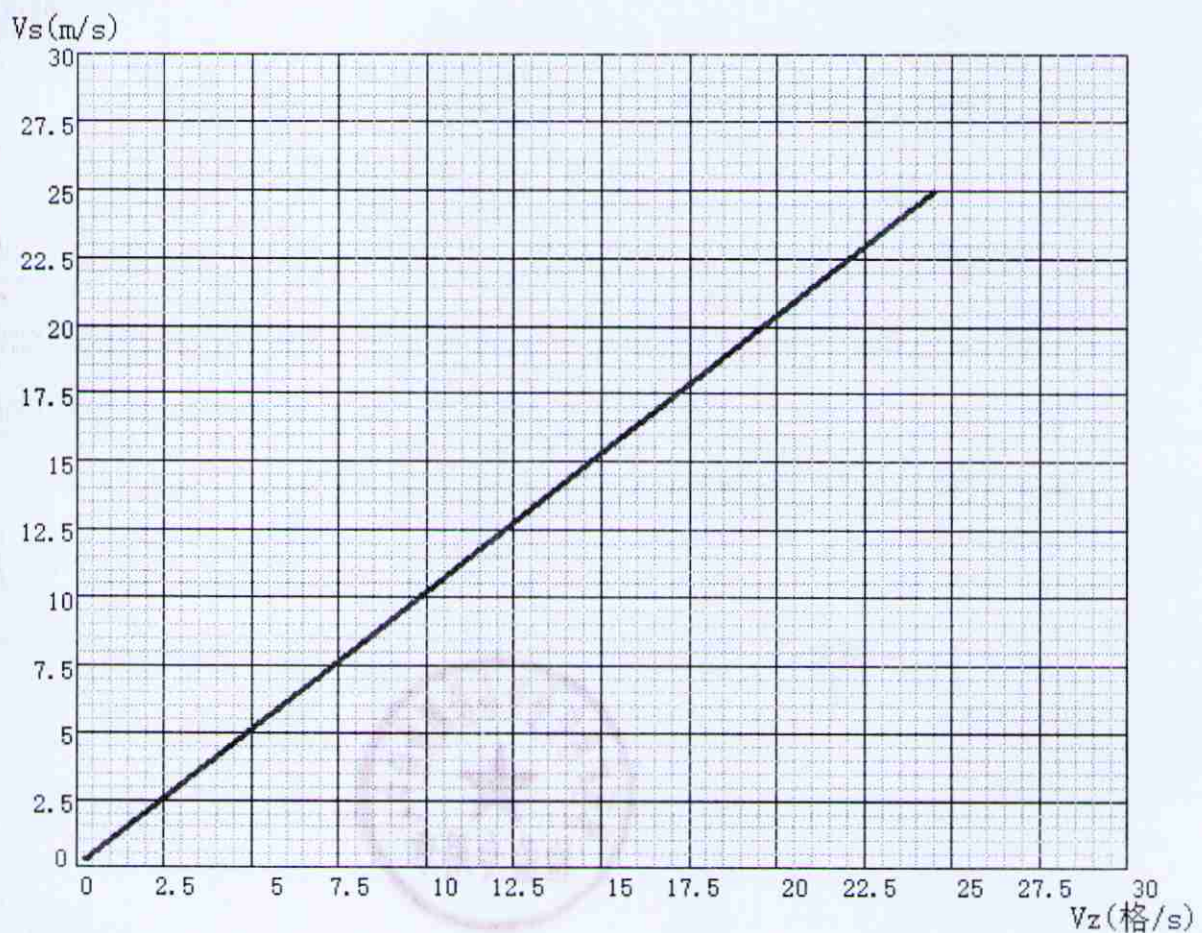
审核：禹磊

主检：梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.34m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.8~25 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.03m/s	合格
备 注				

风表曲线图

曲线方程 $V_s = 1.02 V_z + 0.07$ (m/s)线性度 $L=0.99999$

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检 验 报 告

委托单位: 汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿

样品名称: 中速风表

规格型号: CFJ10

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 09 月 04 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码: 472302

联 系 电 话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿	地 址	汝州市蟒川镇黑龙庙村
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ10
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
检验地点	河南省义市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
到样日期	2026 年 09 月 02 日	检验日期	2026 年 09 月 04 日
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	0275
安标编号	MFH040003	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007 《煤矿用风速表》		
检验设备（标准物质）一览表			
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXX	0.1 级	1026CT0302068
检验环境			
温 度（℃）	18.08	湿度（%RH）	/
大气压（Pa）	98993	其 它	/
检 验 结 论	依据 KA/T380-2007 《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 <u>符合标准要求</u> 。		
备注	检验专用章 签发日期：2026 年 09 月 04 日		

批准：刘永军

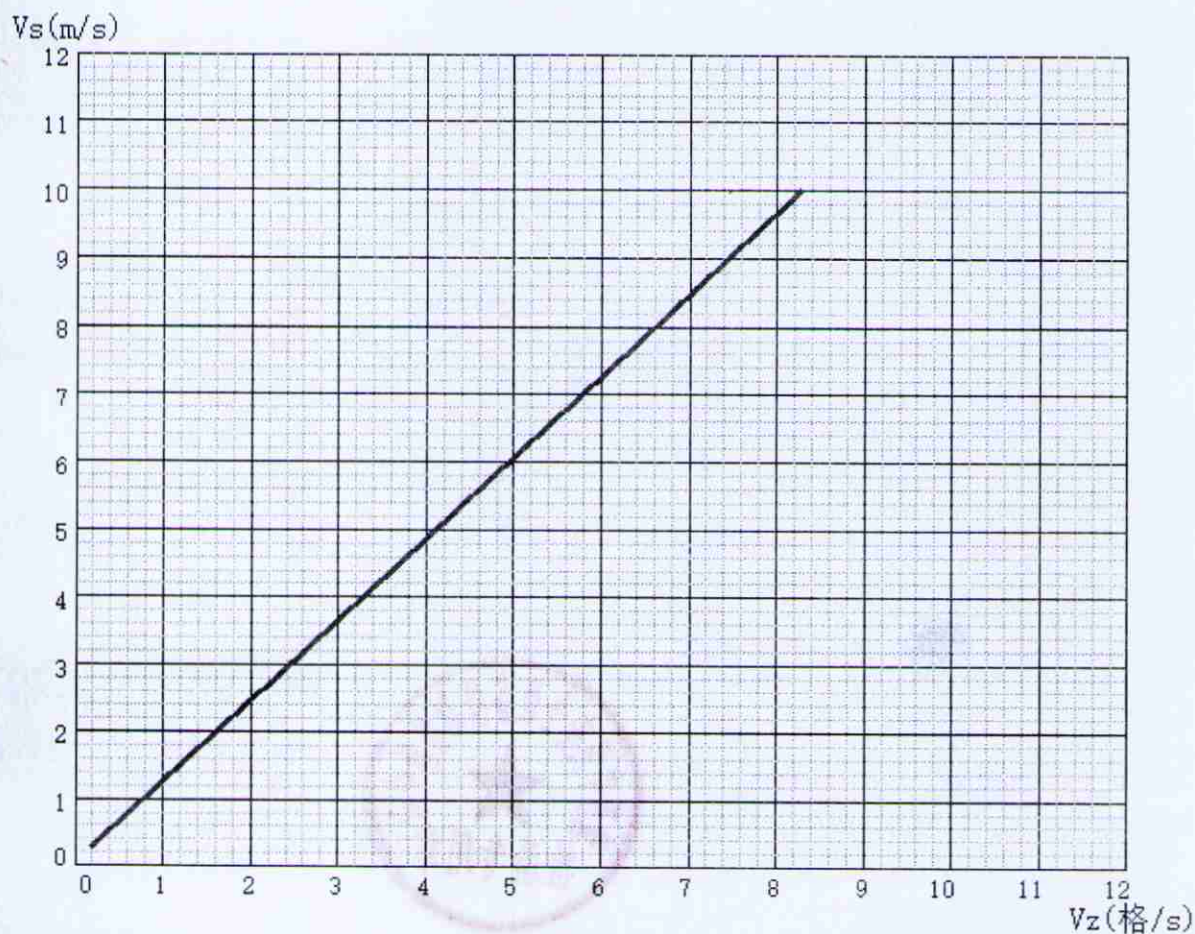
审核：禹磊

主检：梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.3m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.04m/s	合格
备 注				

风表曲线图



以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表
检 验 报 告

委托单位:	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026 年 09 月 04 日



检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)

注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码: 472302

联 系 电 话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿	地 址	汝州市蟒川镇黑龙庙村
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ10
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
检验地点	河南省义市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
到样日期	2026 年 09 月 02 日	检验日期	2026 年 09 月 04 日
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	0272
安标编号	MFH040003	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		
检验设备（标准物质）一览表			
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXX	0.1 级	1026CT0302068
检验环境			
温 度（℃）	18.05	湿度（%RH）	/
大气压（Pa）	98995	其 它	/
检 验 结 论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 <u>符合标准要</u> <u>求</u> 。		
备注			

批准：刘少军

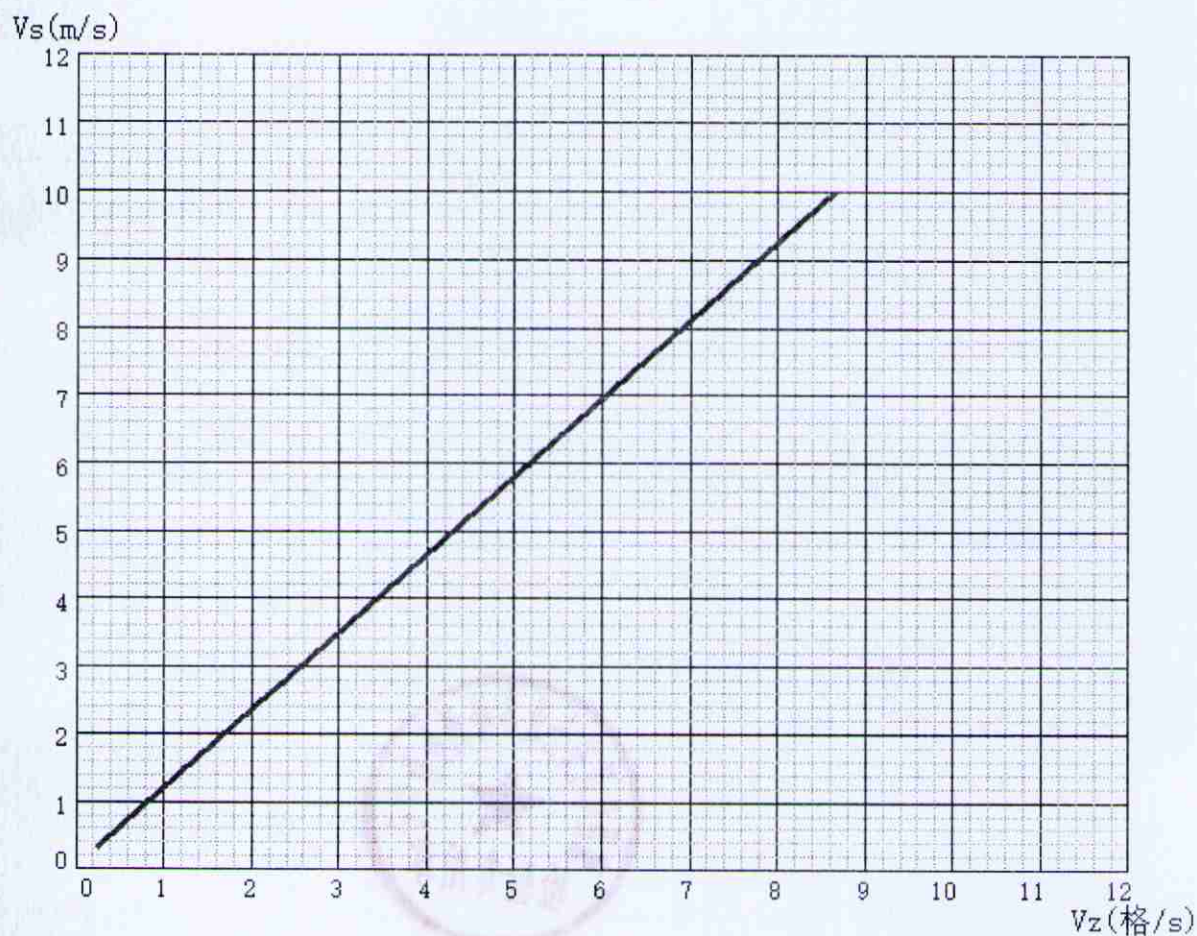
审核：[Signature]

主检：梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.36m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.05m/s	合格
备 注				

风表曲线图

曲线方程 $V_s = 1.15 V_z + 0.08$ (m/s)线性度 $L=0.99995$

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表
检 验 报 告

委托单位：	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
样品名称：	低速风表
规格型号：	CFJ5
检验类别：	委托检验
检验日期：	2026 年 09 月 04 日



检验单位： 豫西矿用安全设备检测检验中心 （公章）

注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码： 472302

联 系 电 话： 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿	地 址	汝州市蟒川镇黑龙庙村
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ5
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
检验地点	河南省义市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
到样日期	2026 年 09 月 02 日	检验日期	2026 年 09 月 04 日
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	0474
安标编号	MFH040004	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		
检验设备（标准物质）一览表			
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXX	0.1 级	1026CT0302068
检验环境			
温 度（℃）	18.11	湿度（%RH）	/
大气压（Pa）	98991	其 它	/
检 验 结 论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目 符合标准要求。		
备 注			

批准：刘海洋

审核：禹磊

主检：梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.2m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.03m/s	合格
备 注				

风表曲线图



以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检 验 报 告

委托单位：	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
样品名称：	低速风表
规格型号：	CFJ5
检验类别：	委托检验
检验日期：	2026 年 09 月 04 日



检验单位： 豫西矿用安全设备检测检验中心 （公章）

注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码: 472302

联 系 电 话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿	地 址	汝州市蟒川镇黑龙庙村
样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ5
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	汝州市神火顺通矿业有限公司丰达煤矿
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 3 楼 308 室	检验类别	委托检验
到样日期	2026 年 09 月 02 日	检验日期	2026 年 09 月 04 日
生产厂家	海城中通仪表有限公司	出厂编号	6837
安标编号	MFH040004	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1 级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃ 分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXX	0.1 级	1026CT0302068

检验环境

温 度（℃）	18.03	湿度（%RH）	/
大气压（Pa）	98984	其 它	/

检 验 结 论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目符合标准要求。 （检验专用章） 签发日期：2026 年 09 月 04 日
备注	

批准：刘海洋

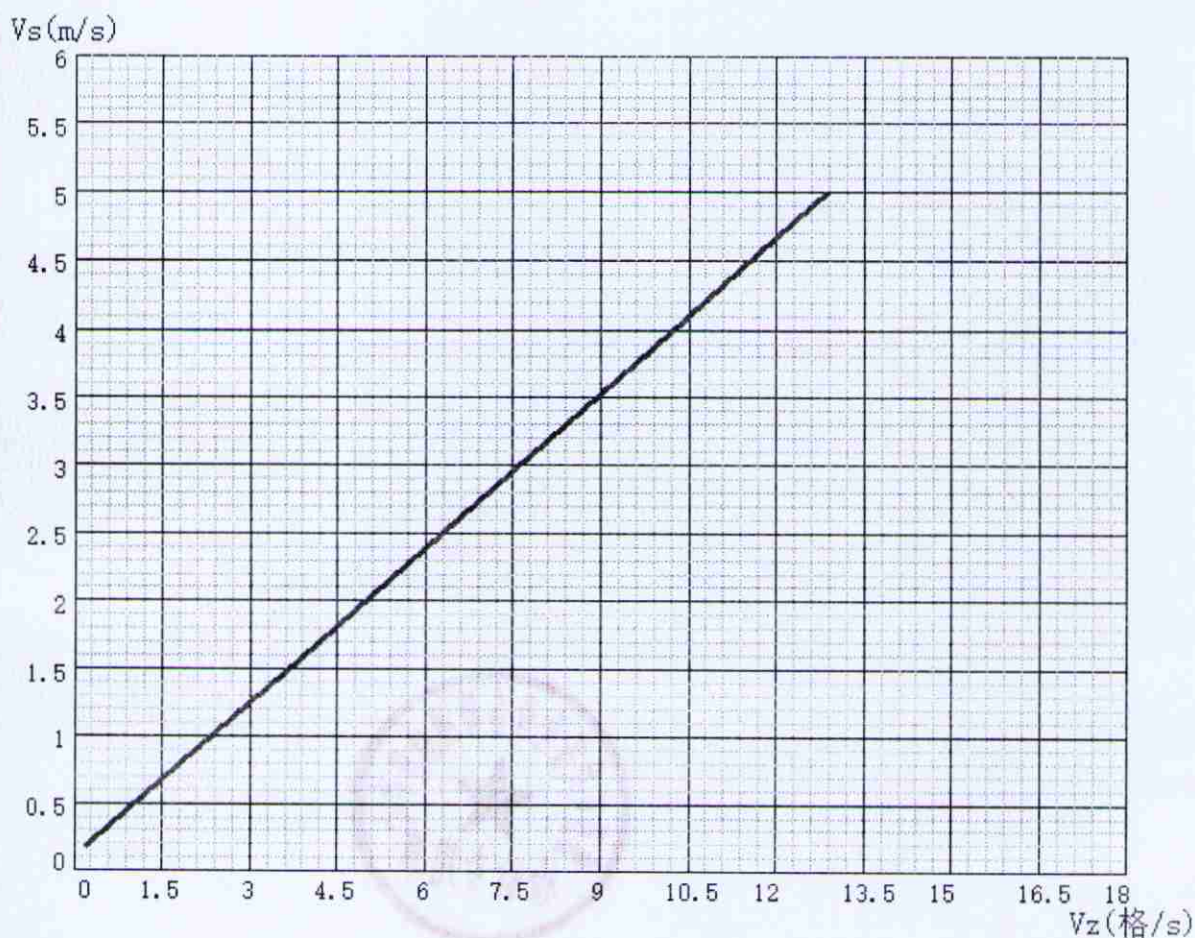
审核：禹磊

主检：梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.19m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.02m/s	合格
备 注				

风表曲线图

曲线方程 $V_s = 0.38 V_z + 0.12$ (m/s)线性度 $L=0.99996$

以下无内容